



Gobernación
de **Nariño**



CÓMO SE LOGRÓ LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO 2018

Claudia Arévalo Caicedo

Coordinadora de Calidad LSP


*Camilo Romero Galeano
GOBERNADOR DE NARIÑO
Omar Andrés Álvarez Mejía*

DIRECTOR INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

IMPLEMENTACIÓN



CRECIMIENTO ÁREA LSP



- 2012: Remodelación del Laboratorio de Entomología. 80 Mts²
- Remodelación del Laboratorio de Control de calidad de las ETV. 36 Mts²
- 2013: Remodelación y ampliación laboratorio Micobacterias
- 2015: Construcción Laboratorio Productos farmacéuticos y toxicología

2008



2018






2008



2018



TALENTO HUMANO

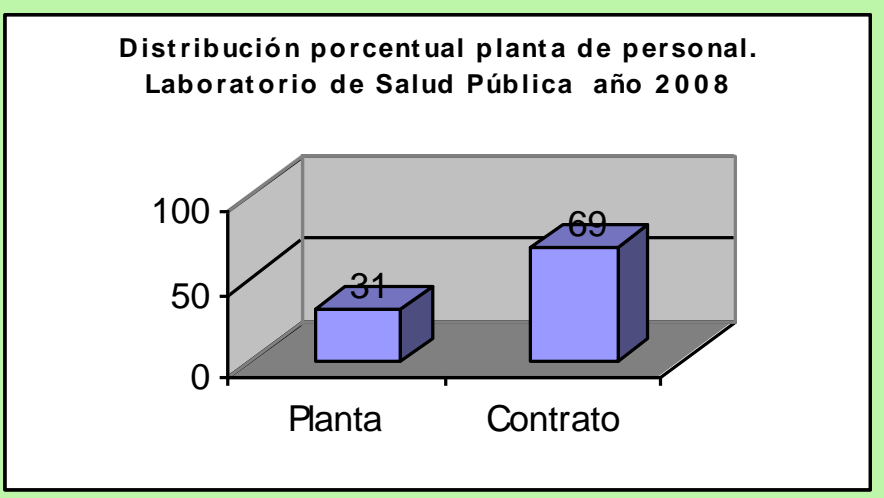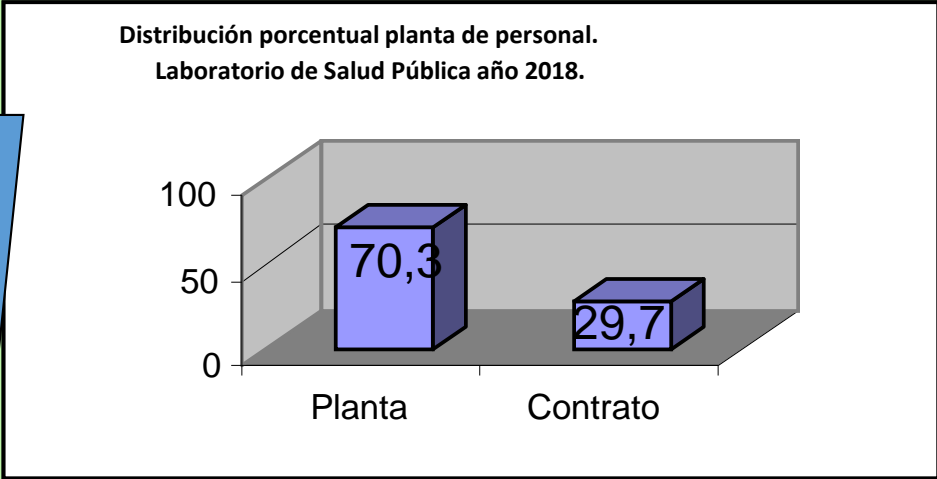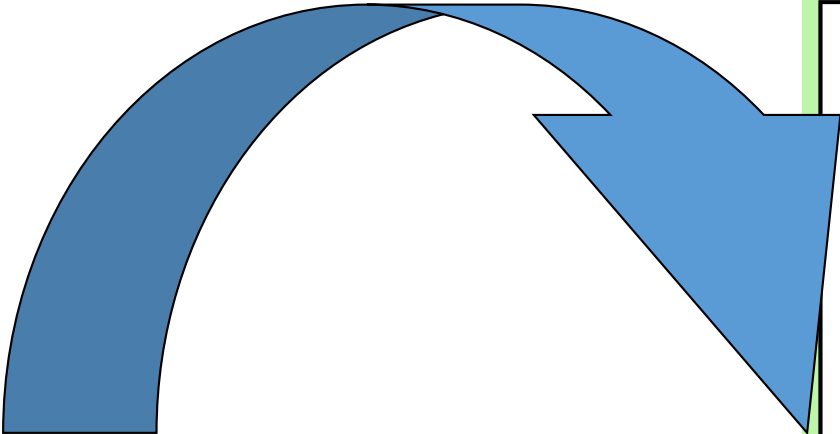

TALENTO HUMANO

2008



2018




BIOSEGURIDAD



EQUIPOS



EQUIPOS



GESTIÓN DE INSUMOS



IMPLEMENTACIÓN

- Sensibilización
- Diagnóstico
- Planeación
- Capacitación
- Diseño
- Documentación
- Implementación
- Verificación

ACREDITACIÓN

- Solicitud de la acreditación ante ONAC
- Evaluación documental
- Evaluación en sitio
- Decisión de acreditación:



ENSAYOS ACREDITADOS

ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO:

Detección de
coliformes totales,
Detección de E.
coli, pH, Turbiedad,
color,
conductividad,
dureza, cloruros



IMPLEMENTACIÓN

- Sensibilización
- Diagnóstico
- Planeación
- Capacitación
- Diseño
- Documentación
- Implementación
- Verificación

ACREDITACIÓN

- Solicitud de la acreditación ante ONAC
- Evaluación documental
- Evaluación en sitio
- Decisión de acreditación:

ACREDITACIÓN LSP

NO. L 2339

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
acredita a:

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
NIT: 891.280.001-0
Calle 15 No.28-41 Plazoleta Bomboná, San Juan de Pasto, Nariño, Colombia.

La evaluación y acreditación de este organismo de evaluación de la conformidad, se han realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional:

ISO/IEC 17025:2005

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo

17-LAB-007

Esta Acreditación está sujeta a que el organismo de evaluación de la conformidad se mantenga conforme con los requisitos especificados, lo cual será evaluado por ONAC. La vigencia de este certificado se puede verificar en www.onac.org.co

Certificado de Acreditación 17-LAB-007

Fecha de Otorgamiento: 2018-01-26 Fecha Última Modificación:

Fecha de Renovación: Fecha de Vencimiento: 2021-01-25

Director Ejecutivo

Página 1 de 3

NO. LA 13686

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ANEXO DE CERTIFICADO
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
17-LAB-007
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2005
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Áreas cubiertas por la acreditación
Dirección del Laboratorio: Cámara 24 # 27-19, Barrio el Colovano - Hospital Civil, San Juan de Pasto - Nariño

CÓDIGO SECTOR GENERAL	CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO	ENSAYO	TÉCNICA	SUBSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR	INTERVALO DE MEDICIÓN	DOCUMENTO NORMATIVO
L15	C4	Detección de Caprominas totales	Número más probable	Agua tratada, agua cruda.	<1 NMP/ 100 mL a 2419,6 NMP/ 100 mL	Standard Methods 9223 ed. 22 2012
L15	C4	Detección de Escherichia coli	Número más probable	Agua tratada, agua cruda.	<1 NMP/ 100 mL a 2419,6 NMP/ 100 mL	Standard Methods 9223 ed. 22 2012
L16	C4	pH	Electrométrico / Potenciométrico	Agua tratada, agua cruda.	4 unidades de pH a 10 unidades de pH	Standard Methods 8001 ed. 22 2012
L16	C4	Conductividad eléctrica	Electrométrico / Potenciométrico	Agua tratada, agua cruda.	10 uS/cm a 1413 uS/cm	Standard Methods 2510B ed. 22 2012
L16	C4	Turbiedad	Colorimetría (comparación, fotométrica y espectrofotométrica, nefelométrica)	Agua tratada, agua cruda.	0,5 NTU a 10 NTU	Standard Methods 2130B ed. 22 2012
L16	C4	Color aparente	Colorimetría (comparación, fotométrica y espectrofotométrica, nefelométrica)	Agua tratada, agua cruda.	5 UC a 100 UC	Standard Methods 2130B ed. 22 2012

Fecha de Otorgamiento: 2018-01-26 Fecha Última Modificación:

Fecha de Renovación: Fecha de Vencimiento: 2021-01-25

NO. LA 13687

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ANEXO DE CERTIFICADO
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
17-LAB-007
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2005
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Áreas cubiertas por la acreditación
Dirección del Laboratorio: Cámara 24 # 27-19, Barrio el Colovano - Hospital Civil, San Juan de Pasto - Nariño

CÓDIGO SECTOR GENERAL	CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO	ENSAYO	TÉCNICA	SUBSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR	INTERVALO DE MEDICIÓN	DOCUMENTO NORMATIVO
L14	C4	Cloruro	Volumétrica	Agua tratada, agua cruda.	7,5 mg Cl ₂ a 100 mg Cl ₂	Standard Methods 8001 ed. 22 2012
L16	C4	Dureza total	Volumétrica	Agua tratada, agua cruda.	10 mg CaCO ₃ a 300 mg CaCO ₃	Standard Methods 2040C ed. 22 2012

Fecha de Otorgamiento: 2018-01-26 Fecha Última Modificación:

Fecha de Renovación: Fecha de Vencimiento: 2021-01-25

LA ACREDITACIÓN EN EL LSP

La Acreditación pretende garantizar con plena evidencia que las pruebas analíticas realizadas en el Laboratorio, cumplen con los más altos estándares de calidad en todos los procedimientos realizados a las muestras que son puestas bajo su responsabilidad, ofreciendo resultados oportunos y con aseguramiento de calidad, con los cuales se ofrece un amplio apoyo a la vigilancia e investigación en salud pública en el Departamento de Nariño.



MARCO NORMATIVO

DECRETO 2323 DE 2006

DECRETO 780 DE 2016

RESOLUCIÓN 1619 DE 2015



- Mantener la acreditación
- Cumplir con el 100% de estándares de calidad
- Ampliar el alcance

EJES ESTRATÉGICOS

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

GESTIÓN DE LA CALIDAD

INVESTIGACIÓN



Gobernación
de **Nariño**



GRACIAS

Calle 15 No. 28 - 41 Plazuela de Bomboná - San Juan de Pasto - Nariño - Colombia

Conmutador: 7235428 - 7236928 - 7233359 - 7232260

Horario de Atención: Lunes a Viernes: 8a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m.

www.idsn.gov.co